Nebulizador de compresor compacto

scian

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODELO: NB-220C

TABLA DE CONTENIDO

1. INSTRUCCIÓN.....1
2. SÍMBOLOS.....1
3. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD---------- 2
4. UNIDAD PRINCIPAL----------3
5. PREPARANDO EL NEBULIZADOR PARA SU USO----------3
6. USANDO EL DISPOSITIVO----------4
7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ----------4
8. CUIDADO DEL DISPOSITIVO----------4
9. ALMACENANDO EL DISPOSITIVO ----------4
10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS----------5
11. OBLIGACIONES DE GARANTÍA ---------- 5
12. CLASIFICACIÓN ---------- ---------- - - - ----------5
9. CONTROLES PERIÓDICOS DE SEGURIDAD----------5
10. ESPECIFICACIONES----------6
11. GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE----------6

INSTRUCCIONES

Gracias por comprar el Nebulizador Compresor Compacto NB-220C.

Este producto fue desarrollado para el tratamiento exitoso del asma, las alergias y otros trastornos respiratorios. El compresor fuerza el aire al nebulizador. Cuando el aire entra en el nebulizador, convierte el medicamento prescrito en un aerosol de gotitas microscópicas que pueden ser fácilmente inhaladas. El paciente es un operador previsto

Contraindicación: Ninguna

SIMBOLOS

SIMBOLOS	SIGNIFICADO
	Fabricante
	Símbolo para el marcado de dispositivos eléctricos y electrónicos según la Directiva 2002/96/CE.El dispositivo, los accesorios y el embalaje deben ser eliminados correctamente al final de su uso. Por favor, siga las reglamentos locales para su eliminación.
	CLASE II
	Manténgase seco
	Atención, consulte los documentos adjuntos
	Tipo BF parte aplicada

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para asegurar el uso correcto del producto, deben seguirse siempre las medidas de seguridad básicas, incluidas las advertencias y precauciones enumeradas en este manual de instrucciones.

ADVERTENCIA

- Para el régimen de medicación deberá seguir las instrucciones de su médico o profesional sanitario autorizado.
- No cubra el compresor con una manta, toalla o cualquier otro tipo de cubierta durante su uso. Esto podría provocar un sobrecalentamiento o un mal funcionamiento del compresor.
- No utilice el dispositivo donde pueda estar expuesto a gases o vapores inflamables.
- No utilice agua mineral en el nebulizador para fines de nebulización.
- Deshágase siempre de cualquier medicamento que quede en el depósito de medicamentos después de cada uso. Use medicamento nuevo cada vez que use el dispositivo.
- No deje el dispositivo o sus partes en lugares donde se exponga a temperaturas extremas o a cambios de humedad, como dejar el dispositivo en un vehículo durante los meses cálidos o calurosos, o donde se exponga a la luz solar directa.

PRECAUCIÓN

- Limite el uso del dispositivo a 20 minutos cada vez, y espere 40 minutos antes de volver a utilizarlo.
- Proporcionar una supervisión estrecha cuando este dispositivo sea utilizado por, sobre o cerca de bebés, niños o personas comprometidas.
- No inserte ningún objeto en el compresor.
- Asegúrate de que el filtro de aire esté limpio. Si el filtro de aire ha cambiado de color o no se ha usado durante 60 días, reemplácelo.
- No inserte ningún objeto en el compresor.
- Asegúrate de que el filtro de aire esté limpio. Si el filtro de aire ha cambiado de color o no se ha usado durante 60 días, reemplácelo.
- Asegúrese de que el kit de nebulización esté correctamente montado, el filtro de aire esté correctamente instalado y el tubo de aire esté correctamente conectado al compresor y al kit de nebulización. El aire puede filtrarse por el tubo de aire durante el uso si no está bien conectado.
- Inspeccione el compresor (unidad principal) y las piezas del nebulizador antes de utilizar el dispositivo. Asegúrese de que no hay piezas dañadas, la boquilla y el tubo de aire no es un bloque y el compresor funciona normalmente
- No utilice el dispositivo si el tubo de aire está doblado.
- No bloquee la cubierta del filtro de aire.
- No altere el deflector, la boquilla del depósito de medicación o cualquier parte del kit de nebulización.
- No añada más de 10 ml de medicamento al depósito de medicamentos.

PRECAUCIÓN

- No utilice el dispositivo a temperaturas superiores a 40°C.
- No incline el kit de nebulización para que el ángulo del kit sea mayor de 45". El medicamento puede fluir hacia la boca.
- No agitar el kit de nebulización mientras se utiliza el dispositivo.
- No someta el compresor, ni ninguno de sus componentes a fuertes golpes, como caídas al suelo.
- Este dispositivo está aprobado sólo para uso humano.
- No desmonte ni intente reparar el dispositivo o los componentes.
- Utilice el dispositivo sólo para el uso previsto, tal como se describe en el manual de instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Deseche el dispositivo, los componentes y los accesorios opcionales de acuerdo con las normativas locales aplicables. La eliminación ilegal puede causar la contaminación del medio ambiente.
- Asegúrese de que el tubo de aire esté bien sujeto al compresor (unidad principal) y a las piezas de nebulización, y que no se suelte. Gire el tubo de aire ligeramente al insertarlo en los conectores para evitar que el tubo se desconecte durante el uso.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- No utilice el compresor (unidad principal) y el cable de alimentación mientras estén mojados.
- No enchufe o desenchufe el cable de alimentación en la toma de corriente con las manos húmedas.
- No sumerja el compresor (unidad principal) en agua u otro líquido. No derrame agua u otros líquidos sobre el compresor. Estas piezas no son impermeables. Si se derrama líquido sobre estas partes, por favor desenchufe el cable de alimentación y limpie el líquido con una gasa u otro material absorbente suave inmediatamente.
- No utilice ni almacene el dispositivo en lugares húmedos o al aire libre. Utilice dentro de la temperatura y la humedad de funcionamiento.
- No sobrecargue las tomas de corriente. Enchufe el dispositivo en el apropiado tomas de corriente
- No utilice cables de extensión. Enchufe el cable de alimentación directamente en la toma de corriente.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente después de usar el dispositivo. Nunca deje este producto desatendido cuando esté enchufado.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar el dispositivo.
- Lea completamente todas las instrucciones incluidas en los accesorios opcionales antes de usarlos.
- No colocar el EQUIPO de manera que sea difícil operar el dispositivo de desconexión.
- El interruptor de alimentación se utiliza para aislar el dispositivo de la red eléctrica.
- La dirección de movimiento del actuador del interruptor de la red de alimentación es conforme a la norma IEC 60447

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los bebés y niños sin supervisión. El dispositivo puede contener pequeñas partes que pueden ser ingeridas.
- No deje la solución de limpieza en las piezas del nebulizador. Enjuague las piezas del nebulizador con agua caliente y limpia del grifo después de la desinfección.
- Lave las piezas del nebulizador después de cada uso. Seque las piezas inmediatamente después de lavarlas.
- No guarde el tubo de aire con humedad o medicamentos que queden en el tubo de aire. Esto podría provocar una infección como resultado de las bacterias.
- Guarde el dispositivo y los componentes en un lugar limpio y seguro.
- No lleve ni deje el nebulizador con medicación en el depósito de medicación.
- No coloque ni intente secar el dispositivo, los componentes o cualquiera de las piezas del nebulizador en un horno microondas.
- No envuelva el cable de alimentación alrededor del compresor (unidad principal).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Los siguientes son mantenimiento y reparación que pueden ser tomados por el operador, o que deben ser operados por el fabricante o distribuidor.

Servicio y mantenimiento	Responsable
Cambiar el tubo de inhalación	Operador
Cambiar la parte aplicada	Operador
Cambiar el filtro de aire	Operador
Limpiar la superficie del dispositivo	Operador
Limpieza y desinfección diaria	Operador
Todos los componentes que deben ser reparados o cambiados separando el dispositivo	Centro de servicio autorizado del distribuidor o fabricante

ADVERTENCIA:

- No modifique este equipo sin la autorización del fabricante.
- No realice el servicio o mantenimiento del dispositivo mientras se usa con el paciente

UNIDAD DE MANEJO

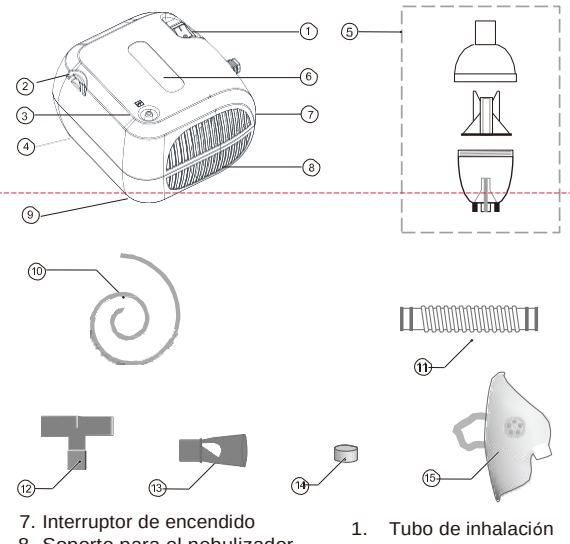

7. Interruptor de encendido
8. Soporte para el nebulizador
9. Tapón de aire
10. Cubierta de la pantalla antipolvo
11. Nebulizador Kil
12. Logo
13. Unidad principal
14. Vía térmica

1. Tubo de inhalación
2. Tubo corrugado
3. Conector tipo T
4. Boquilla de inhalación
5. Filtro de aire
6. Máscara (Opcional)

PREPARACION DEL NEBULIZADOR PARA SU USO

PRECAUCIÓN

- Limpiar y desinfectar el kit de nebulización y las mascarillas opcionales antes de usarlas por primera vez después de la compra.
- Si el dispositivo no se ha utilizado durante un largo período de cal,
- por favor, limpia y desinfecta el kit de nebulización y las mascarillas opcionales antes de usarlas.
- Para evitar el riesgo de infección cruzada, nunca deben utilizarse diferentes personas en el mismo equipo de nebulización.

1. En el uso normal, coloque el dispositivo en una superficie estable, sólida y plana, en posición horizontal, de manera que la unidad pueda ser fácilmente alcanzada. cuando estás sentado.
   Precaución: coloque el dispositivo al menos a 10 cm de distancia de las paredes o cuando estás sentado.
2. Asegúrese de que la unidad está en la posición "off"(O) presionando el lado derecho del interruptor.
3. Inserte el enchufe en la toma de corriente.
4. Gire la tapa de inhalación en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar la tapa de inhalación del depósito de medicación.
5. Añade la cantidad correcta de medicamento prescrito al depósito de medicamentos.
6. Gire la tapa de inhalación en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté bien cerrada.
7. Coloque el accesorio de inhalación deseado.

CONECTANDO EL TUBO DE AIRE

1. Empuje el tapón de aire de un extremo del tubo de aire hacia el conector de aire del lado frontal del compresor.
2. Empuje el tapón de aire del otro extremo del tubo de aire hacia el conector del tubo de aire en la parte inferior del kit del nebulizador.

USO DEL DISPOSITIVO

1. Enciende la energía.
2. Enchufe el tubo de inhalación en el tapón de aire bajo la cubierta del dispositivo.
3. Conecta el otro lado del tubo en el puerto de ventilación de la parte inferior del kit de nebulización.
4. Enchufe el kit de nebulización en el soporte del dispositivo.
5. Añade la medicina en el tanque de nebulización.
6. Abre el botón O/I
7. El dispositivo comienza a nebulizar.
8. Presione el botón O/I para terminar de forma segura el funcionamiento del nebulizador
9. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente después de usar el dispositivo



PRECAUCIÓN
El paciente y el operador deben mantener una distancia del dispositivo entre 20 y 50 cm en el uso normal.
Uso de la máscara para niños o la máscara para adultos
Coloca la máscara sobre la nariz y la boca. Tire de la cinta elástica sobre la cabeza. Tire suavemente de la correa para sujetar la máscara sobre la nariz y la boca. Inhale la medicación. Exhale normalmente a través de la máscara.
NOTA: la máscara es un producto de subcontratación, se compró a fabricantes profesionales con certificación CE

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

LIMPIEZA
Si se siguen las instrucciones de limpieza después de cada uso, se evitará que se seque el medicamento que quede en el frasco, lo que hará que el dispositivo no nebulice eficazmente y ayudará a prevenir las infecciones.
Lave las partes del nebulizador después de cada uso. Seca las partes inmediatamente después de lavarlas.
1. Retire el accesorio de inhalación (máscara o boquilla) del kit de nebulización.
2. Desconecte el tubo de aire del nebulizador.
3. Gire suavemente la parte superior de inhalación en sentido contrario a las agujas del reloj y levante para separar el nebulizador en dos secciones.
4. Retire el deflector.
5. Descarte el resto de la medicación.
6. Enjuague todas las partes de los accesorios (kit de nebulización, la boquilla y la mascarilla) en agua tibia y un detergente suave. Finalmente enjuague bien con agua tibia.
7. Secado a mano o al aire libre en un ambiente limpio con un paño suave y limpio sin pelusas.
8. LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO Y DE LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL TUBO Utilice únicamente un paño humedecido con detergente antibacteriano (no abrasivo y sin disolventes de ningún tipo).
Ensamble el nebulizador y guarde el kit de nebulización en una bolsa seca y sellada
PRECAUCIÓN:
El kit de nebulización debe ser reemplazado cada 6 meses.
DESINFECCIÓN
Se puede desinfectar diariamente remojando las partes en desinfectante médico que se comercializan en todas las farmacias. Si su médico o terapeuta respiratorio especifica un procedimiento de limpieza diferente, siga sus instrucciones. La desinfección efectiva sólo es posible si el
El nebulizador ha sido limpiado.
Desinfectar los accesorios (kit de nebulización, mascarilla, boquilla) después del último tratamiento del día.
1. Desconecte todas las partes de acuerdo con los pasos anteriores de 1 a 5.
2. Llenar un recipiente, adecuado para contener todos los componentes individuales a desinfectar, con una solución de agua potable y desinfectante,
respetando las proporciones indicadas en el envase del propio desinfectante
3. Sumergir completamente cada componente individual en la solución, teniendo cuidado de evitar la formación de burbujas de aire en contacto con los componentes. Deje los componentes sumergidos durante el período de tiempo indicado en el envase del desinfectante, y asociado a la concentración elegida para preparar la solución.
4. Retire los componentes ahora desinfectados y enjuague a fondo con agua potable tibia.
5. Secado a mano o al aire libre en un ambiente limpio con un paño suave y limpio sin pelusas.
6. Ensamble el nebulizador y guarde los accesorios en una bolsa seca y sellada.

CUIDADO DEL DISPOSITIVO

Para mantener el dispositivo en las mejores condiciones y protegerlo de daños, siga estas instrucciones:

LIMPIEZA EL DISPOSITIVO
Limpie la carcasa de la unidad principal con un paño suave humedecido con agua o un detergente suave. No utilice limpiadores abrasivos. Seque la carcasa inmediatamente con un paño suave y limpio.
CAMBIAR EL FILTRO DE AIRE
Cambie el filtro de aire cada 60 días aunque el filtro de aire no parezca estar sucio. Si el filtro de aire parece estar sucio, o si se ha derramado agua o medicamentos sobre el filtro de aire, cámbielo por uno nuevo inmediatamente.
1. Tire de la cubierta del filtro de aire para quitarlo de la parte delantera del compresor.
2. Retire el filtro sucio con la mano.
PRECAUCIÓN
No intente lavar o limpiar el filtro de aire. Los filtros de aire húmedos pueden causar obstrucciones. No sustituya el filtro de aire por algodón o cualquier otro material.
PRECAUCIÓN
Lave la cubierta del filtro de aire con regularidad para evitar cualquier obstrucción en la cubierta. No hierva. Asegúrese de que la tapa esté seca antes de colocar el nuevo filtro de aire.
3. Inserte un nuevo filtro de aire en la cubierta del filtro de aire.
PRECAUCIÓN
Antes de insertar el nuevo filtro de aire, asegúrese de que el filtro de aire esté limpio y sin polvo. No utilice el dispositivo sin el filtro de aire.
4. Vuelve a poner la tapa del filtro de aire en el compresor.
5. No realice el mantenimiento ni la reparación del dispositivo mientras esté en uso.

CUIDADO DEL DISPOSITIVO

1. Ponga el kit de nebulización y el accesorio de inhalación (boquilla o máscara) en una bolsa seca y sellada. Coloque la bolsa en el bolsillo de almacenamiento de la bolsa de transporte.
2. Enrolle el tubo de aire y colóquelo en el bolsillo de almacenamiento.
3. Ponga el compresor en la bolsa de transporte.
4. Cierra la bolsa con la cremallera.
5. Guarda el dispositivo en un lugar seguro y limpio. No guarde el dispositivo en temperaturas extremadamente calientes o frías, con alta humedad o bajo la luz directa del sol.

ADVERTENCIA
No deje el dispositivo o sus partes en lugares donde se exponga a temperaturas extremas o a cambios de humedad, como dejar el dispositivo en un vehículo durante los meses cálidos o calurosos, o donde se exponga a la luz solar directa.
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los bebés y niños sin supervisión. El dispositivo puede contener pequeñas partes que pueden ser ingeridas.

PRECAUCIÓN
No lleve ni deje el nebulizador con la medicación en el depósito de la misma.
No desmonte ni intente reparar el dispositivo o los componentes
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La unidad no se enciende cuando el interruptor está encendido.	El cable de alimentación de CA no está conectado a una toma de corriente.	Apaga el interruptor de encendido. Enchufe el enchufe en una toma de corriente. Encienda el dispositivo.
No hay nebulización o baja tasa de nebulización cuando la energía está encendida.	No hay medicamentos en el depósito de medicamentos. Demasiado o muy poco medicamento en el tanque de medicación.	Añade la cantidad correcta de medicamento prescrito al depósito de medicamentos.
	El kit de nebulización no está correctamente montado.	Asegúrese de que el kit de nebulización esté correctamente montado y el accesorio de inhalación esté correctamente colocado.
	El kit nebulizador está inclinado en un ángulo incorrecto.	Sostén el kit de nebulización correctamente. No incline el kit de nebulización para que el ángulo del kit sea mayor de 45 grados.
	El tubo de aire está mal colocado.	Asegúrese de que el tubo de aire esté correctamente conectado al compresor y al kit de nebulización.
	El tubo de aire está doblado o dañado. El tubo de aire está bloqueado.	Asegúrate de que el tubo de aire no esté doblado, torcido o doblado. Inspeccione el tubo de aire para ver si está dañado. Reemplace el tubo de aire si está dañado.
El dispositivo está muy caliente.	El compresor está cubierto. El dispositivo ha sido usado por más de 20 minutos.	No cubra el compresor con ningún tipo de cubierta durante su uso. Apague el aparato. Espere 40 minutos antes de volver a utilizar el dispositivo.

OBLIGACIONES DE GARANTÍA

1. La garantía de este nebulizador de compresor compacto es de 12 meses desde la fecha de compra.
2. Las obligaciones de garantía están prescritas por el certificado de garantía para el comprador.
3. Las direcciones de las organizaciones para el mantenimiento de la garantía están presentes en el certificado de garantía.

Clasificación del equipo con respecto a la protección contra las descargas eléctricas: CLASE II
Grado de protección contra las descargas eléctricas: TIPO BF
El grado de protección contra el ingreso de agua está clasificado como IPXO. Equipo no apto para ser utilizado en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso.
Operación intermitente: 20 minutos ON, 40 minutos OFF.

CLASIFICACIÓN

Inspección preventiva y mantenimiento que debe realizarse, incluida la frecuencia de dicho mantenimiento
1. Por favor, limpie el enchufe del cable de alimentación al menos una vez al año. Demasiado polvo en el enchufe puede causar el incendio.
2. Los siguientes controles de seguridad deben realizarse al menos cada 12 meses por una persona calificada que tenga la formación, los conocimientos y la experiencia práctica adecuados para realizar estas pruebas.

CONTROLES PERIÓDICOS DE SEGURIDAD

a. Inspeccione el equipo y los accesorios para ver si hay daños mecánicos y funcionales.
b. Inspeccione las etiquetas de seguridad relevantes para la legibilidad.
c. Inspeccione el fusible para verificar el cumplimiento de las características de corriente y de ruptura.
d. Verifique que el dispositivo funciona correctamente como se describe en las instrucciones de uso.
e. Pruebe la corriente de contacto según la norma IEC 60601-1 Límite: NC 100uA, SFC: 500uA.
f. Pruebe la corriente de fuga del paciente según la norma IEC 60601-1 Límite: para corriente alterna: 100 uA, para corriente continua: 10 uA.
g. Pruebe la corriente de fuga del paciente en condiciones de fallo único según la norma IEC 60601-1 Límite: para c.a.: 0,5 mA, para c.c.: 50uA. La corriente de fuga nunca debe exceder el límite. Los datos deben registrarse en un registro del equipo. Si el dispositivo no funciona correctamente o falla en alguna de las pruebas anteriores, el dispositivo debe ser reparado.

ESPECIFICACIONES

Modelos	NB-220C
Voltaje nominal	AC 120V, 60HZ 1.4A
Presión extrema	>205Kpa
Rango de flujo libre	16-23.5Umin
Presión nebulizadora	100-190Kpa
Nivel de ruido	S 65dB
Potencia nominal	S200VA
Capacidad máxima del equipo de	6 ml.
El tamaño de las partículas	S 5μm y 60%
Tasa de nebulización	Alrededor de 0,2 ml/min
Modo de operación	20 minutos encendido, 40
Operación Temperatura y humedad presión atmosférica	De -10°-c a +40°C, y menos. 860-1060hPa
Temperatura de transporte y almacenamiento y la presión atmosférica/húmeda	De -10°-c a +40°C, 95% y menos, 500-1060hPa
Tamaño	145mmx137mmx92mm
Grados de contaminación	Grados 2
Categoría de sobretensión	Categoría II
Altas altitudes (m)	2000m
Accesorios	Boquilla del nebulizador, tubo de inhalación. Conector tipo T, tubo corrugado

NOTAS
- Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.
- Tenga en cuenta que las especificaciones pueden variar según el tipo de medicamento utilizado.
- No utilice el dispositivo donde pueda estar expuesto a gas inflamable.
- Esta unidad confirma la norma EMC IEC60601-1-2. Sin embargo, si se utiliza junto con otros dispositivos médicos o equipos eléctricos, pueden influir en el funcionamiento de uno de ellos. Por favor, siga las instrucciones de los manuales y utilice todos los dispositivos correctamente.

NEBULIZADOR DE COMPRESOR Con respecto a la descarga eléctrica, el fuego y los riesgos mecánicos sólo de acuerdo con IEC60601-1.

Guía y declaración de fabricación - emisiones electromagnéticas - para todos los EQUIPOS y SISTEMAS

Ensayo de emisión Cumplimiento Entorno electromagnético - guía		
El NB-220C está destinado a ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente del usuario del NB-220C debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno		
Prueba de emisión	Cumplimiento	Entorno electromagnético - guía
Emisión de RF CISPR 11	Grupo 1	El NB-220C utiliza la energía de RF sólo para su función interna. Por lo tanto, sus emisiones de radiofrecuencia son muy bajas y no es probable que causen ninguna interferencia en los equipos electrónicos cercanos.
Emisión de RF CISPR 11	Class B	El NB-220C es adecuado para su uso en todos los establecimientos, incluidos los establecimientos domésticos y los que están conectados directamente a la red pública de suministro de energía de baja tensión que abastece a los edificios utilizados para las fluctuaciones/ fines domésticos.
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	ClassA	
Voltaje Cumple con las fluctuaciones/ Emisiones de parpadeo IEC 61000-3-3	Cumple	

REQUERIMIENTO PARA EL REGISTRO

MODELO	
Período de garantía	Un año desde la fecha de compra
Fecha de compra	
Tienda de compras	Nombre: Teléfono: Dirección:
Cliente	Nombre: Teléfono: Dirección:

REQUERIMIENTO PARA EL REGISTRO

Fecha	PROBLEMA	HOMBRE DE SERVICIO
Reglamento de garantía	1. Durante el período de garantía, la reparación puede hacerse en cualquier departamento de reparación de nebulizadores. 2. Las siguientes cosas no pertenecen al rango de garantía: (a) Operar el nebulizador de forma diferente a los procedimientos o instrucciones del manual. (b) El cuerpo es dañado artificialmente. (c) Reparar o modificar la construcción del monitor de cualquier manera. (d) Problema que se produce en caso de calamidades naturales y otras fuerzas mayores.	

HONSUN (NANTONG) CO.,LTD.
Address:No.8, Tongxing Road, Economic&Technical Development Area, Nantong City, Jiangsu, P.R.China

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso en interés del progreso. No se darán avisos previos en caso de que se produzcan modificaciones en este manual. Las marcas y nombres mencionados son propiedad de las empresas correspondientes.